


nanoTymp Immittanz-Bericht

Berichtsdatum 18.09.2020
Patient: MackTeam
Test
08.06.2020




Mack Medizintechnik GmbH
Schirmbeckstraße 13
85276 Pfaffenhofen a.d. Ilm

Tympanogramme

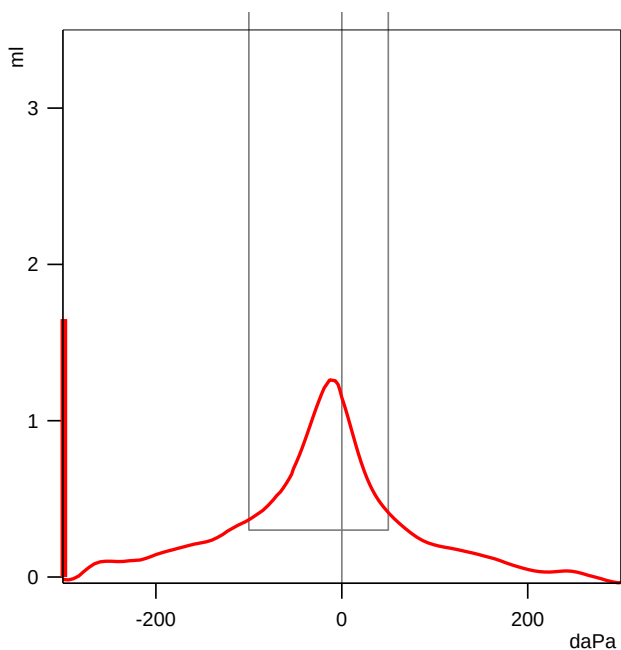

Rechtes Ohr

ECV: 1,7 ml
Peak: 1,3 ml / -10 daPa - A
Sondenton: 226 Hz
Druck: -300...300 daPa at 150 daPa/s

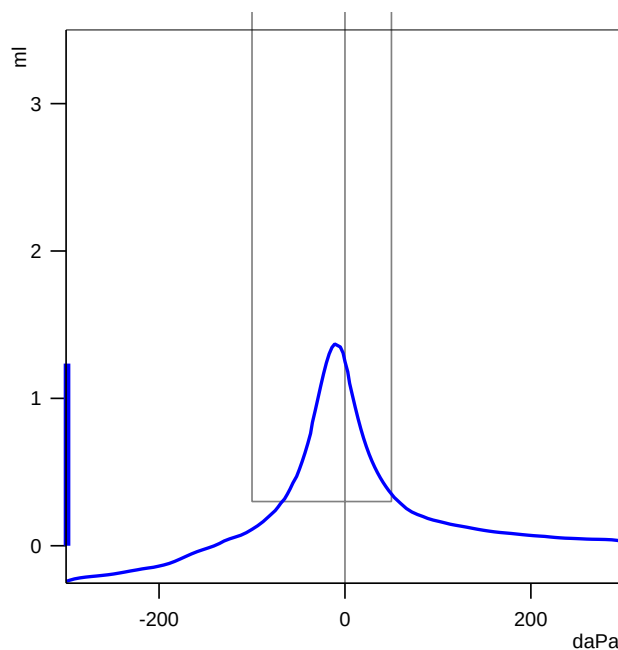

Linkes Ohr

ECV: 1,2 ml
Peak: 1,4 ml / -8 daPa - A
Sondenton: 226 Hz
Druck: -300...300 daPa at 150 daPa/s

Reflexe

Ohr	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	BBN
Links	90	90	85	95	94
Rechts	90	85	90	85	94 (NR)

Sie finden uns auch im Internet unter www.mack-team.de